

Bitte beachten für TS Instrumente: Daten für die unteren und oberen Grenzwerte müssen manuell in die QC-Bereiche eingepflegt werden (System Manager)

Analyzer	TS
Level	1
LOT	2139
Ablauf	31.12.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.15	7.12	7.18	
pCO2	71	67	76	mmHg
pCO2	9.46	8.93	10.13	kPa
pO2	74	66	82	mmHg
pO2	9.86	8.80	10.93	kPa
tHb	20.5	19.7	21.3	g/dL
tHb	12.74	12.23	13.22	mmol/L
SO2	82	79	85	

Bitte beachten für TS2 Instrumente: Anwender können die Barcodes für die QC direkt einscannen, wenn kein Haken bei 'RiliBÄK aktivieren' gesetzt ist.

Analyzer	TS2
Level	1
LOT	2139
Ablauf	31.12.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.15	7.12	7.18	
pCO2	71	67	76	mmHg
pCO2	9.46	8.93	10.13	kPa
pO2	74	66	82	mmHg
pO2	9.86	8.80	10.93	kPa
tHb	20.5	19.7	21.3	g/dL
tHb	12.74	12.23	13.22	mmol/L
SO2	82	79	85	

Barcode A



213912243071271867760660821972137985

Barcode B



213912241241322831000000149173000000

Bitte beachten für TS Instrumente: Daten für die unteren und oberen Grenzwerte müssen manuell in die QC-Bereiche eingepflegt werden (System Manager)



Analyzer	TS
Level	2
LOT	2239
Ablauf	31.12.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.40	7.37	7.43	
pCO2	44	41	46	mmHg
pCO2	5.87	5.47	6.13	kPa
pO2	99	92	106	mmHg
pO2	13.20	12.26	14.13	kPa
tHb	14.2	13.6	14.8	g/dL
tHb	8.82	8.44	9.18	mmol/L
SO2	90	87	93	

Bitte beachten für TS2 Instrumente: Anwender können die Barcodes für die QC direkt einscannen, wenn kein Haken bei ‚RiliBÄK aktivieren‘ gesetzt ist.

Analyzer	TS2
Level	2
LOT	2239
Ablauf	31.12.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.40	7.37	7.43	
pCO2	44	41	46	mmHg
pCO2	5.87	5.47	6.13	kPa
pO2	99	92	106	mmHg
pO2	13.20	12.26	14.13	kPa
tHb	14.2	13.6	14.8	g/dL
tHb	8.82	8.44	9.18	mmol/L
SO2	90	87	93	

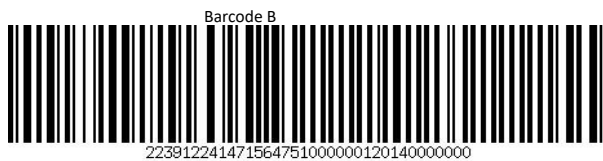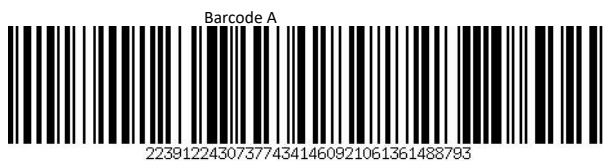

Bitte beachten für TS Instrumente: Daten für die unteren und oberen Grenzwerte müssen manuell in die QC-Bereiche eingepflegt werden (System Manager)

Analyzer	TS
Level	3
LOT	2339
Ablauf	30.11.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.60	7.57	7.63	
pCO2	24	23	26	mmHg
pCO2	3.20	3.07	3.47	kPa
pO2	137	129	144	mmHg
pO2	18.26	17.20	19.20	kPa
tHb	9.2	8.8	9.6	g/dL
tHb	5.70	5.46	5.96	mmol/l
SO2	97	94	99.9	

Bitte beachten für TS2 Instrumente: Anwender können die Barcodes für die QC direkt einscannen, wenn kein Haken bei 'RiliBÄK aktivieren' gesetzt ist.

Analyzer	TS2
Level	3
LOT	2339
Ablauf	30.11.2024

Parameter	Zielwert	unt. Grenzw.	ob. Grenzw.	Einheit
pH	7.60	7.57	7.63	
pCO2	24	23	26	mmHg
pCO2	3.20	3.07	3.47	kPa
pO2	137	129	144	mmHg
pO2	18.26	17.20	19.20	kPa
tHb	9.2	8.8	9.6	g/dL
tHb	5.70	5.46	5.96	mmol/l
SO2	97	94	99.9	

